



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански преградак 34, ПАК 105305
телефон: (011) 328 - 2736, телефон: (011) 2181 - 668

На основу члана 9. став 1. и члана 12. Закона о метрологији ("Службени лист СЦГ", бр. 44/2005), а на захтев ИНСА а.д., Земун, ул. Тршћанска бр. 21, Дирекција за мере и драгоцене метале доноси:

УВЕРЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

Назив мерила:

Водомер за топлу воду

Ознака основног типа:

VVS

Произвођач мерила:

ИНСА а.д., Земун

Службена ознака типа:

Z - 14 - 41

Рок важења уверења:


31.10.2018. године

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролоским условима за водомере ("Службени лист СФРЈ", бр. 51/86).

Број: 393-2/1-01-3529
Београд, 31.10.2008. године

ДИРЕКТОР

др Јелена Пантелић-Бабић

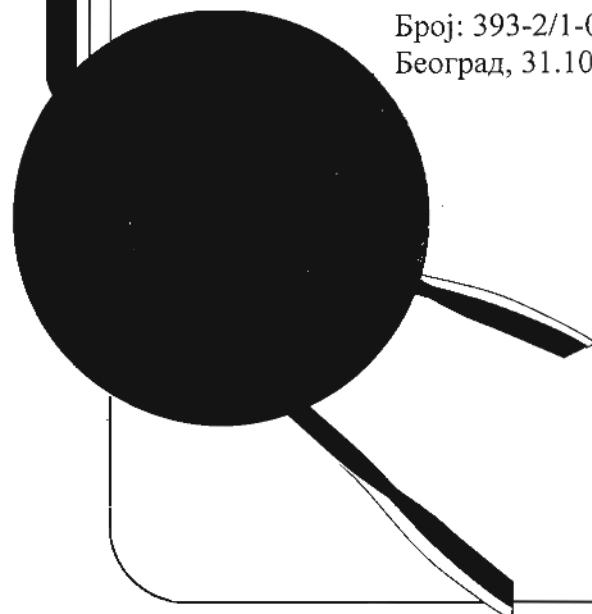



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305
телефон: (011) 32-82-736, телефон: (011) 2181- 668

На основу члана 9. став 1. и члана 12. Закона о метрологији ("Службени лист СЦГ", бр. 44/2005), а на захтев ИНСА а.д., Земун, ул. Тршћанска бр. 21, Дирекција за мере и драгоцене метале доноси:

**У ВЕРЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА**

Назив мерила:

Водомер за топлу воду

Ознака основног типа:

VVS

Произвођач мерила:

ИНСА а.д., Земун

Службена ознака типа:

Z - 14 - 41

Рок важења уверења:

31.10.2018. године

Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове прописане Правилником о метролошким условима за водомере ("Службени лист СФРЈ", бр. 51/86).

Број: 393-2/1-01-3529
Београд, 31.10.2008. године



ПРИЛОГ УВЕРЕЊУ
О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА
БРОЈ: 393-2/1-01-3529

1. МЕТРОЛОШКА СВОЈСТВА МЕРИЛА

1.1. Границе дозвољених грешака

- $\pm 5\%$ за $q_{\min} \leq q < q_t$;
- $\pm 3\%$ за $q_t \leq q \leq q_{\max}$;
- $\pm 3\%$ за q_{\min} до q_{\max} за водомере у саставу мерила топлотне енергије.

1.2. Мерни опсези и називне вредности

Називни пречник mm	q_{\max}	q_n	q_t	q_{\min}	Називни притисак bar	Приклучак	Ознака производњача
	m^3/h	L/h					
15; 20	3	1,5	120	30	16	H	VVS-3T
20	5	2,5	200	50			
25; 32	10	5	400	100			
40	20	10	800	200			
15	3	1,5	120	30		V	

H - хоризонтални

V - вертикални

1.3. Референтни услови

Радна температура воде је до $+130^{\circ}\text{C}$.

1.4. Намена мерила

Водомери се користе за мерење укупне запремине топле воде протекле кроз водомер, инсталirаних код потрошача у стамбеним објектима.


1.5. Основе карактеристике конструкције и функционалност мерила

Главни делови водомера су кућиште са регулатором за подешавање, чашица са пропелером, магнетни преносник и бројчаник.

Принцип рада водомера заснива се на обртању пропелера под утицајем протока воде, смештеног у чашици по чијем ободу су распоређени отвори за проток и смер струјања воде (слика 1).

Обртање пропелера преноси се посредством магнетног преносника на бројчаник, тако да је број обратаја пропелера пропорционалан запремини воде протекле кроз водомер која се региструје као укупна запремина на бројчанику водомера.


Бројчаник водомера је потпуно заштићен од утицаја воде и влаге.

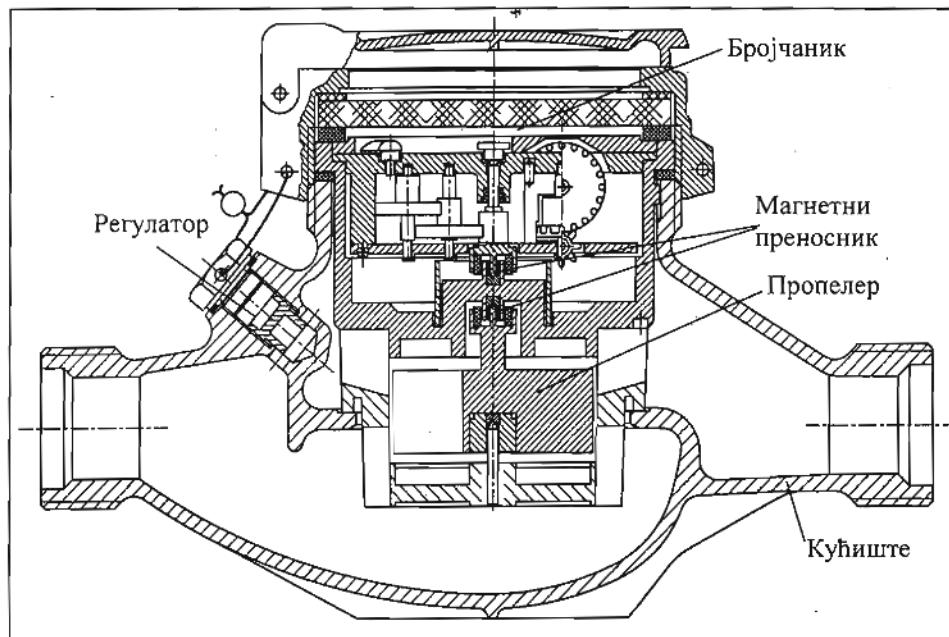

Слика 1. Водомер у пресеку

На бројчанику водомера може се приклучити уређај (заштићен од утицаја воде) за давање електричних импулса ради даљинског очитавања података о запремини воде.

Изглед бројчаника водомера приказан је на слици 2. и спољашњи изглед водомера приказан је на слици 3.

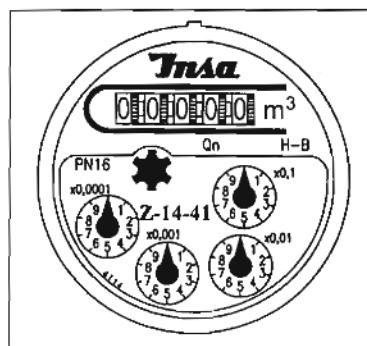

Слика 2. Бројчаник водомера



Слика 3. Спољашњи изглед водомера

1.6. Натписи и ознаке

Натписи и ознаке се наносе на плочу бројчаник испод стакла, прстенастом металном затварачу и кућишту (стрелица за смер струјања воде) водомера као што је приказано на сликама 2.и 3.

2. ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊЕ МЕРИЛА

2.1. Метролошко упутство

Преглед мерила се обавља према Метролошком упутству за преглед водомера ("Гласник", број 2/1990).

2.2. Врсте и места стављања жигова

Водомер типа VVS, жигоше се основним и годишњим жигом Дирекције на пломби на месту приказаном на слици 3.

